

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

**Verbale della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione della documentazione presentata dalle ditte partecipanti alla procedura di gara per la fornitura di n.2 ecotomografi occorrenti al poliambulatorio patria di Alessandria
R.D.O. N. 4986792**

VERBALE N. 2

L'anno 2025, addì 13, del mese di Ottobre alle ore 09,40 ca., presso la S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale - sita in Novi Ligure, Via E. Raggio n. 12 (AL), si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del Direttore S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale dell'A.S.L. AL n.375 del 13.03.2025 nelle seguenti persone:

Presidente

• Dott. Santoro Antonello – S.S. Radiodiagnostica Tortona - Dirigente Medico – (nota prot. n. INF/221 del 26.02.2025)

Componenti

• Dott.ssa Francesca Pasquali – S.S. Vulnologia Clinica Tortona - Dirigente Medico (nota prot. n. INF/221 del 26.02.2025)

• Ing. Massimo Giacobbe – S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche (nota prot. n. INF/248 del 03.03.2025)

E' presente alla seduta la Sig.ra Elena Demergasso della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale con funzioni esclusivamente di segreteria.


La Commissione Giudicatrice richiama preliminarmente il verbale redatto in data 21.07.2025 rilevando che nella precedente seduta era stato deciso di effettuare la prova "on site" come prescritto dall'art. 10 del Capitolato Speciale di gara.

A tale scopo, la S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale ha provveduto ad inoltrare le convocazioni nei confronti delle Ditte concorrenti, secondo il seguente calendario:

Ditta ESAOTE SPA ore 09:00 – 10:00 del 17.09.2025;
Ditta B.E.S.T. SRL ore 10:30 – 11:30 del 17.09.2025;
Ditta M.C.S SRL ore 12:00 – 13:30 del 17.09.2025;
Ditta VERIS SRL ore 14:30 – 15:30 del 17.09.2025;

La Commissione Giudicatrice riferisce che le prove sono state effettuate alla presenza dei seguenti incaricati delle Ditte partecipanti:

Ditta ESAOTE SPA: Sig. Prandi Pier Franco carta d'identità n. CA02955KS – Sig. Gazzo Massimo carta d'identità n. CA28609UX

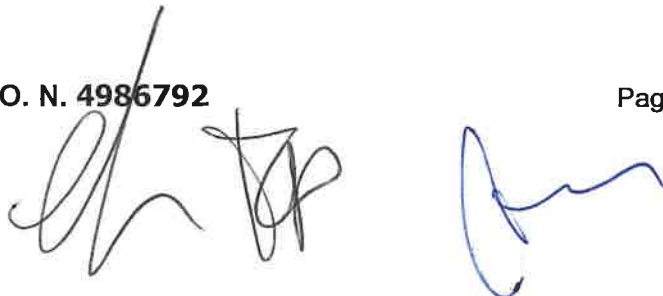

Ditta B.E.S.T. SRL: Sig. Palladino Luca carta d'identità n. AX5886017 - Sig. Pellegrino Marco carta d'identità n. CA58350IJ

Ditta M.C.S SRL: Sig. Proletti Simone carta d'identità n. CA19462IQ - Sig.ra Colombara Sylwia carta d'identità n. CA29473KX

Ditta VERIS SRL: Sig. Mereu Andrea carta d'identità n. CA18358OY

La Commissione ha assistito alla dimostrazione pratica dell'utilizzo degli ecotomografi alla presenza, separata, degli incaricati di ciascuna Ditta e dà atto che:

- le operazioni sono avvenute presso il reparto presso il reparto presso il Poliambulatorio Patria di Via Antonio Pacinotti, 38, 15121 Alessandria – ambulatorio di Vulnologia nel giorno 19.09.2025 con il seguente calendario:

dalle ore 09:17 circa alle ore 10:27 con la Ditta Esaote Spa;

dalle ore 11:05 alle ore 12:05 con la ditta M.C.S SRL;

dalle ore 12:20 alle ore 13:20 con la Ditta B.E.S.T. SRL presentatasi in ritardo per problemi tecnici;

dalle ore 14:10 alle ore 15:00 ed infine con la Ditta VERIS SRL

- a tutte le ditte è stata richiesta la valutazione ecografica di un ginocchio e dell'addome e tutte le ditte sono risultate idonee.

La Commissione Giudicatrice, sulla scorta delle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale di gara, sulla base della documentazione tecnica prodotta dai soggetti concorrenti e sulle considerazioni espresse nel corso della prova "on site", decide di attribuire i seguenti coefficienti di giudizio tecnico afferenti per il parametro "Qualità":

RIF.	SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA	MAX PUNTI	DITTA B.E.S.T. SRL	DITTA ESAOTE SPA	DITTA M.C.S. SRL
B-1	Descrizione delle caratteristiche del sistema	D	6	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,8 Punteggio = 4,8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 6	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,9 Punteggio = 5,4
B-2	Data immissione sul mercato ed ultima release software	Q	2	Punteggio = 2	Punteggio = 1	Punteggio = 0
B-3	Pannello operativo: dimensioni in pollici del pannello operativo	Q	2	Punteggio = 1,79	Punteggio = 1,70	Punteggio = 2
B-4	Pannello operativo touchscreen	T	2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2
B-5	Caratteristiche Monitor	Q	2	Punteggio = 1,79	Punteggio = 2	Punteggio = 1,98
B-6	Dotato di 4 ruote pivotanti per una facile trasportabilità frenabili singolarmente.	T	2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2
B-7	Sistema di ottimizzazione automatica del Bmode, della traccia Doppler PW/CW e regolazione della PRF sia manuale a step che automatica tramite tasto dedicato.	T	2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2

B-8	Dotato di misure specifiche e generiche.	D	4	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 4	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 4	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 4
B-9	Software per il calcolo automatico della frazione di eiezione.	D	7	Giudizio = Mediocre Coefficiente = 0,5 Punteggio = 3,5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 7	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 7
B-10	Software specifico per la visualizzazione tridimensionale del flusso sanguigno con sonde bidimensionali, senza l'utilizzo di software 3D volumetrico.	T	5	Requisito presente Punteggio = 5	Requisito presente Punteggio = 5	Requisito presente Punteggio = 5
B-11	Software per la visualizzazione del microcircolo ad elevato frame rate ed elevata risoluzione.	D	5	Giudizio = Mediocre Coefficiente = 0,5 Punteggio = 2,5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 5	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 5
B-12	Dynamic range	D	3	Giudizio = Sufficiente Coefficiente = 0,6 Punteggio = 1,8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 3	Giudizio = Mediocre Coefficiente = 0,5 Punteggio = 1,5
B-13	Autonomia in minuti della batteria sia in funzionamento che in stand by	Q	2	Punteggio = 1,33	Punteggio = 2	Punteggio = 2
B-14	Protezione del sistema contro virus o malware.	T	1	Requisito presente Punteggio = 1	Requisito presente Punteggio = 1	Requisito presente Punteggio = 1
B-15	Durata garanzia di tutto il sistema oltre i 36 mesi	Q	5	Punteggio = 4	Punteggio = 5	Punteggio = 0
B-16	Caratteristiche Sonda 2D convex addominale	D	6	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 6	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 6	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 6
B-17	Caratteristiche Sonda 2D phased array	D	6	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 6	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 6	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 6
B-18	Caratteristiche Sonda 2D lineare	D	3	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 3	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 3	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 3
B-19	Organizzazione assistenza tecnica con valutazione del numero, del profilo professionale ed esperienza dei tecnici specializzati che verranno utilizzati; tempi intervento in caso di guasto. Presenza di unità muletto gratuita	D	5	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,8 Punteggio = 4	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 5	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,8 Punteggio = 4

	TOTALE		70	58,51	68,70	59,88
	TOTALE riparametrato			59,61	70	61,01

Note

Punto B-1

Ditta B.E.S.T. SRL: l'attrezzatura proposta presenta 3 porte attive Bmode.

Alla prova on site la Commissione Giudicatrice ha rilevato la presenza di un monitor con una minore definizione di quello presentato dalla ditta ritenuta Eccellente.

La Ditta non è produttrice di sonde, caratteristica che potrebbe prolungare i tempi di risoluzione in caso di un eventuale sostituzione.

Ditta ESAOTE SPA: l'attrezzatura proposta presenta 5 porte attive Bmode.

Alla prova on site la Commissione Giudicatrice ha rilevato la presenza di un monitor che alla prova on site risulta avere la migliore risoluzione rispetto alle Ditte concorrenti.

La ditta è produttrice di sonde.

Ditta M.C.S. SRL l'attrezzatura proposta presenta 5 porte attive Bmode.

Alla prova on site la Commissione Giudicatrice ha rilevato la presenza di un monitor con una minore definizione di quello presentato dalla ditta ritenuta Eccellente.

La ditta è produttrice di sonde.

Punto B-2

Ditta B.E.S.T. SRL l'attrezzatura proposta ha come data immissione sul mercato 2024 e l'ultima release software è datata 2025 - pari ad una differenza minima annua = 1 dal miglior aggiornamento

Ditta ESAOTE SPA l'attrezzatura proposta ha come data immissione sul mercato 2023 e l'ultima release software è datata 2025 - pari ad una differenza minima annua = 2 dal miglior aggiornamento

Ditta M.C.S. SRL la ditta non dichiara la data immissione e l'ultima release software.

Punto B-3:

Ditta B.E.S.T. SRL presenta un pannello operativo di 14 pollici.

Ditta ESAOTE SPA presenta un pannello operativo di 13,3 pollici.

Ditta M.C.S. SRL presenta un pannello operativo di 15,6 pollici.

Punto B-4

Caratteristica presente in tutte le offerte.

Punto B-5

Ditta B.E.S.T. SRL presenta un pannello operativo di 21,5 pollici.

Ditta ESAOTE SPA presenta un pannello operativo di 24 pollici.

Ditta M.C.S. SRL presenta un pannello operativo di 23,8 pollici.

Punto B-6

Caratteristica presente in tutte le offerte.

Punto B-7

Caratteristica presente in tutte le offerte.

Punto B-9

Per quanto riguarda la Ditta B.E.S.T. SRL, nonostante la presenza del sales specialist, la Commissione Giudicatrice durante la prova on site non è riuscita a visionare le funzionalità del "Software per il calcolo automatico della frazione di eiezione" in maniera esaustiva.

Punto B-10

Caratteristica presente in tutte le offerte.

Punto B-11

Per quanto riguarda la Ditta B.E.S.T. SRL, nonostante la presenza del sales specialist, la Commissione Giudicatrice durante la prova on site non è riuscita a visionare le funzionalità del "Software per la visualizzazione del microcircolo ad elevato frame rate ed elevata risoluzione." in maniera esaustiva.

Punto B-12

Per quanto riguarda la valutazione del "dynamic range" (ove maggiore è il valore in dB, maggiore è la capacità del sistema di distinguere meglio tra strutture con diverse caratteristiche, registrando un rapporto più ampio tra il segnale più forte e quello più debole) la Commissione Giudicatrice decide di valutare l'efficienza in base a quanto dichiarato dalle ditte:

Ditta B.E.S.T. SRL dichiara 372 dB (decibel).

Ditta ESAOTE SPA dichiara 870 dB (decibel).

Ditta M.C.S. SRL dichiara 260 dB (decibel).

Punto B-13

Ditta B.E.S.T. SRL dichiara autonomia della batteria sia in funzionamento che in stand by di 80 minuti.

Ditta ESAOTE SPA dichiara autonomia della batteria sia in funzionamento che in stand by di 120 minuti.

Ditta M.C.S. SRL dichiara autonomia della batteria sia in funzionamento che in stand by di 120 minuti.

Punto B-14

Caratteristica presente in tutte le offerte.

Punto B-15

Ditta B.E.S.T. SRL presenta una garanzia pari a 48 mesi.

Ditta ESAOTE SPA presenta una garanzia pari a 60 mesi.

Ditta M.C.S. SRL presenta una garanzia pari a 36 mesi.

Punto B-16

La Commissione Giudicatrice alla prova on site rileva che le caratteristiche delle "Sonde 2D convex addominale" sono equivalenti per tutte le offerte presentate.

Punto B-17

La Commissione Giudicatrice alla prova on site rileva che le caratteristiche delle "Sonde 2D phased array" sono equivalenti per tutte le offerte presentate.

Punto B-18


La Commissione Giudicatrice alla prova on site rileva che le caratteristiche delle "Sonde 2D lineare" sono equivalenti per tutte le offerte presentate.

Punto B-19

Ditta B.E.S.T. SRL dichiara un tempo di intervento: entro 48 (quarantotto) ore solari dalla richiesta di intervento.

Ditta ESAOTE SPA dichiara un tempo di intervento: entro 8 (otto) ore solari dalla richiesta di intervento e la disponibilità ad organizzare corsi di istruzione periodici, su richiesta, per il personale medico, per la divulgazione di informazioni tecnico-teoriche di base sull'operatività dell'utilizzo clinico dei sistemi ecografici.

Ditta M.C.S. SRL dichiara un tempo di intervento: entro 48 (quarantotto) ore solari dalla richiesta di intervento.

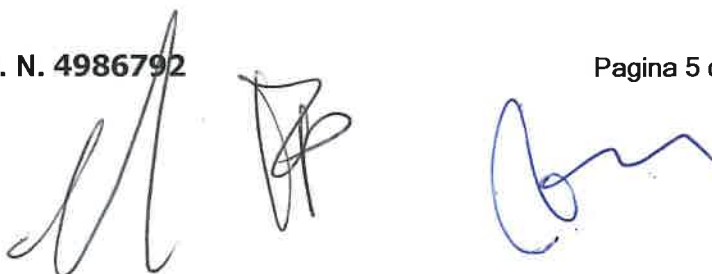

LOTTO 2

RIF.	SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE	TIPO LOGICA	MAX PUNTI	DITTA B.E.S.T. SRL	DITTA ESAOTE SPA	DITTA M.C.S. SRL	DITTA VERIS SRL
B-1	Descrizione delle caratteristiche del sistema	D	9	Giudizio = Discreto Coefficiente = 0,7 Punteggio = 6,3	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 9	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 0,9 Punteggio = 8,1	Giudizio = Buono Coefficiente = 0,8 Punteggio = 7,2
B-2	Data immissione sul mercato ed ultima release software	Q	2	Punteggio = 2	Punteggio = 1	Punteggio = 0	Punteggio = 0,33
B-3	Pannello operativo: dimensioni in pollici del pannello operativo	Q	2	Punteggio = 1,79	Punteggio = 1,70	Punteggio = 2	Punteggio = 1,54
B-4	Pannello operativo touchscreen	T	2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2
B-5	Caratteristiche Monitor	Q	2	Punteggio = 1,79	Punteggio = 2	Punteggio = 1,98	Punteggio = 1,79
B-6	Dotato di 4 ruote pivotanti per una facile trasportabilità frenabili singolarmente.	T	1	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito assente Punteggio = 0
B-7	Sistema di ottimizzazione automatica del Bmode, della traccia Doppler PW e regolazione della PRF sia manuale a step che automatica tramite tasto dedicato.	T	2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2
B-8	Descrizione del programma relativo alle misure specifiche ostetriche divise per trimestri legate al preset specifico corrispondente, IA che consenta di effettuare automaticamente le misure morfologiche di riferimento.	D	8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8
B-9	Espandibilità a imaging tridimensionale volumetrico	T	2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2	Requisito presente Punteggio = 2
B-10	Software specifico per la visualizzazione tridimensionale del flusso sanguigno con sonde bidimensionali, senza l'utilizzo di software 3D volumetrico.	T	7	Requisito presente Punteggio = 7	Requisito presente Punteggio = 7	Requisito presente Punteggio = 7	Requisito presente Punteggio = 7

B-11	Preset specifico di fabbrica per ecocardiografia fetale comprensivo di pacchetto calcoli.	T	5	Requisito presente Punteggio = 5	Requisito presente Punteggio = 5	Requisito presente Punteggio = 5	Requisito presente Punteggio = 5
B-12	Caratteristiche e valori del dynamic range	D	2	Giudizio = Sufficiente Coefficiente = 0,6 Punteggio = 1,2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 2	Giudizio = Mediocre Coefficiente = 0,5 Punteggio = 1	Giudizio = Mediocre Coefficiente = 0,5 Punteggio = 1
B-13	Autonomia in minuti della batteria sia in funzionamento che in stand by.	Q	1	Punteggio = 0,67	Punteggio = 1	Punteggio = 1	Punteggio = 0,33
B-14	Protezione del sistema contro virus o malware.	T	1	Requisito presente Punteggio = 1	Requisito presente Punteggio = 1	Requisito presente Punteggio = 1	Requisito presente Punteggio = 1
B-15	Durata garanzia di tutto il sistema oltre i 36 mesi	Q	5	Punteggio = 4	Punteggio = 5	Punteggio = 0	Punteggio = 0
B-16	Caratteristiche Sonda 2D convex addominale	D	6	Giudizio = Discreto Coefficiente = 0,7 Punteggio = 4,2	Giudizio = Discreto Coefficiente = 0,7 Punteggio = 4,2	Giudizio = Discreto Coefficiente = 0,7 Punteggio = 4,2	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 6
B-17	Caratteristiche Sonda 2D endocavitaria vaginale	D	8	Giudizio = Sufficiente Coefficiente = 0,6 Punteggio = 4,8	Giudizio = Sufficiente Coefficiente = 0,6 Punteggio = 4,8	Giudizio = Discreto Coefficiente = 0,7 Punteggio = 5,6	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 8
B-18	Organizzazione assistenza tecnica con valutazione del numero, del profilo professionale ed esperienza dei tecnici specializzati che verranno utilizzati; tempi intervento in caso di guasto. Presenza di unità muletto gratuita	D	5	Giudizio = Buono Coefficiente = 1 Punteggio = 4	Giudizio = Eccellente Coefficiente = 1 Punteggio = 5	Giudizio = Buono Coefficiente = 1 Punteggio = 4	Giudizio = Ottimo Coefficiente = 1 Punteggio = 4,5
	TOTALE		70	59,75	64,70	56,88	57,69
	TOTALE riparametrato			64,64	70	61,53	62,41

Note

Punto B-1

Ditta B.E.S.T. SRL: l'attrezzatura proposta presenta 3 porte attive Bmode.

Alla prova on site la Commissione Giudicatrice ha rilevato la presenza di un monitor con una minore definizione di quello presentato dalla ditta ritenuta Eccellente.

La Ditta non è produttrice di sonde, caratteristica che potrebbe prolungare i tempi i tempi di risoluzione in caso di un eventuale sostituzione.

Ditta ESAOTE SPA: l'attrezzatura proposta presenta 5 porte attive Bmode.

Alla prova on site la Commissione Giudicatrice ha rilevato la presenza di un monitor che alla prova on site risulta avere la migliore risoluzione rispetto alle Ditte concorrenti.

La ditta è produttrice di sonde.

Ditta M.C.S. SRL l'attrezzatura proposta presenta 5 porte attive Bmode.

Alla prova on site la Commissione Giudicatrice ha rilevato la presenza di un monitor con una minore definizione di quello presentato dalla ditta ritenuta Eccellente.

La ditta è produttrice di sonde.

Ditta VERIS SRL l'attrezzatura proposta presenta 4 porte attive Bmode.

Alla prova on site la Commissione Giudicatrice ha rilevato la presenza di un monitor con una minore definizione di quello presentato dalla ditta ritenuta Eccellente.

La Ditta non è produttrice di sonde, caratteristica che potrebbe prolungare i tempi i tempi di risoluzione in caso di un eventuale sostituzione.

Punto B-2

Ditta B.E.S.T. SRL l'attrezzatura proposta ha come data immissione sul mercato 2024 e l'ultima release software è datata 2025 - pari a una differenza minima annua = 1 dal miglior aggiornamento.

Ditta ESAOTE SPA l'attrezzatura proposta ha come data immissione sul mercato 2023 e l'ultima release software è datata 2025 - pari a una differenza minima annua = 2 dal miglior aggiornamento.

Ditta M.C.S. SRL la ditta non dichiara la data immissione e l'ultima release software.

Ditta VERIS SRL l'attrezzatura proposta ha come data immissione sul mercato 2021 e l'ultima release software è datata 2023 - pari a una differenza minima annua = 6 dal miglior aggiornamento.

Punto B-3:

Ditta B.E.S.T. SRL presenta un pannello operativo di 14 pollici.

Ditta ESAOTE SPA presenta un pannello operativo di 13,3 pollici.

Ditta M.C.S. SRL presenta un pannello operativo di 15,6 pollici.

Ditta VERIS SRL presenta un pannello operativo di 12 pollici.

Punto B-4

Caratteristica presente in tutte le offerte.

Punto B-5

Ditta B.E.S.T. SRL presenta un pannello operativo di 21,5 pollici.

Ditta ESAOTE SPA presenta un pannello operativo di 24 pollici.

Ditta M.C.S. SRL presenta un pannello operativo di 23,8 pollici.

Ditta VERIS SRL presenta un pannello operativo di 21,5 pollici.

Punto B-6

Ditta B.E.S.T. SRL caratteristica presente.

Ditta ESAOTE SPA caratteristica presente.

Ditta M.C.S. SRL caratteristica presente.

Ditta VERIS SRL caratteristica non presente.

Punto B-7

Caratteristica presente in tutte le offerte.

Punto B-8

La Commissione Giudicatrice alla prova on site rileva che *"i programmi relativi alle misure specifiche ostetriche divise per trimestri legate al preset specifico corrispondente, IA che consenta di effettuare automaticamente le misure morfologiche di riferimento"* sono equivalenti per tutte le offerte presentate.

Punto B-9

Ditta B.E.S.T. SRL caratteristica presente.

Ditta ESAOTE SPA caratteristica presente.

Ditta M.C.S. SRL caratteristica non specificata nella documentazione tecnica. Nel corso dell'effettuazione prova on site la Commissione Giudicatrice ha peraltro rilevato la presenza di tale caratteristica sul modello presentato.

Ditta VERIS SRL caratteristica presente.

Punto B-10

Caratteristica presente in tutte le offerte.

Punto B-11

Caratteristica presente in tutte le offerte.

Punto B-12

Per quanto riguarda la valutazione del "dynamic range" (ove maggiore è il valore in dB, maggiore è la capacità del sistema di distinguere meglio tra strutture con diverse caratteristiche, registrando un rapporto più ampio tra il segnale più forte e quello più debole la Commissione Giudicatrice decide di valutare l'efficienza in base a quanto dichiarato dalle ditte:

Ditta B.E.S.T. SRL dichiara 372 dB (decibel).

Ditta ESAOTE SPA dichiara 870 dB (decibel).

Ditta M.C.S. SRL dichiara 260 dB (decibel).

Ditta VERIS SRL dichiara 280 dB (decibel).

Punto B-13

Ditta B.E.S.T. SRL dichiara autonomia della batteria sia in funzionamento che in stand by di 80 minuti.

Ditta ESAOTE SPA dichiara autonomia della batteria sia in funzionamento che in stand by di 120minuti

Ditta M.C.S. SRL dichiara autonomia della batteria sia in funzionamento che in stand by di 120 minuti.

Ditta VERIS SRL dichiara autonomia della batteria sia in funzionamento che in stand by di 40 minuti.

Punto B-14

Caratteristica presente in tutte le offerte.

Punto B-15

Ditta B.E.S.T. SRL presenta una garanzia pari a 48 mesi.

Ditta ESAOTE SPA presenta una garanzia pari a 60 mesi.

Ditta M.C.S. SRL presenta una garanzia pari a 36 mesi.

Ditta VERIS SRL presenta una garanzia pari a 36 mesi.

Punto B-16

La Ditta VERIS SRL; presenta un sistema con ottimizzazione "automatica" delle immagini, ritenuto elemento importante a supporto dell'utilizzatore, non presente nei sistemi delle ditte concorrenti.

Punto B-17

Ditta B.E.S.T. SRL non presenta un sistema che include la funzione urologica e il supporto guida per biopsia.

Ditta ESAOTE SPA non presenta un sistema che include la funzione urologica e il supporto guida per biopsia.

Ditta M.C.S. SRL presenta un sistema che include la funzione urologica ma non il supporto guida per biopsia.

Ditta VERIS SRL presenta un sistema che include la funzione e urologica e il supporto guida per biopsia.

Punto B-18

Ditta B.E.S.T. SRL dichiara un tempo di intervento: entro 48 (quarantotto) ore solari dalla richiesta di intervento.



Ditta ESAOTE SPA dichiara un tempo di intervento: entro 8 (otto) ore solari dalla richiesta di intervento e la disponibilità ad organizzare corsi di istruzione periodici, su richiesta, per il personale medico per informazioni tecnico-teoriche di base sull'operatività dell'utilizzo clinico dei sistemi ecografici.

Ditta M.C.S. SRL dichiara un tempo di intervento: entro 48 (quarantotto) ore solari dalla richiesta di intervento.

Ditta VERIS SRL dichiara un tempo di intervento: entro 24 (ventiquattro) ore solari dalla richiesta di intervento.

Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del procedimento, dichiara chiusa la seduta alle ore 11,40 ca. Viene redatto il presente verbale, che composto da n.10 facciate comprese le sottoscrizioni, viene letto e così approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice.

IL PRESIDENTE

Dott. Santoro Antonello



I Componenti

Dott.ssa Francesca Pasquali



Ing. Massimo Giacobbe

